Rapport d'intervention

Pile Interne et Maintenance N°15003

Client	SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION		
Site	CENTRE REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS		
Réalisée le	17/06/2026 16:11		
Technicien(s)	HAIRABEDIAN JULIEN	**Adresse**	RUE DU RABELIN VERNON (27200)
N° série Joulemètre :	036993100338	**Coordonnées**	2 - +33628560998 (SYLVAIN PASSELERGUE) 3 - spasselergue@sna27.fr (SYLVAIN PASSELERGUE)
Date de validité de l'étalonnage :	01/11/2028		

Contact

Description

Type d'intervention:	**VISITE**
Intervention réalisable ?	**Oui**

DEFIBRILLATEUR

Type défibrillateur	**Défibrillateur Automatique DAE**
MARQUE	**SCHILLER**
MODELE	**FRED EASY**
Numéro de Série	
Position précise exacte ?	☑

Rapport d'intervention

Localisation :	**Acceuil**
Intérieur / Extérieur:	**Intérieur Bâtiment Accès Privé**
Accès:	**Heures Ouvrables Uniquement**
Aspect Physique du DAE/DSA:	**Bon**
Housse de protection:	**Inclus**
Défibrillateur mobile:	**Non**
Mise à jour software:	**V2006B2**
Maintenance interne:	☑
Date Maintenance Interne:	**17/06/2026**
Date Remplacement Pile:	**17/06/2026**

TEST DEFIBRILLATEUR

Acceptation Test de Chocs:	**Oui**
ENERGIE 1	
Mesure N°1 (en Joules) :	**153.2**
Conformité:	**Conforme**
ENERGIE 2	
Mesure N°2 (en Joules) :	**154.2**
Conformité:	**Conforme**
ENERGIE 3	
Mesure N°3 (en Joules) :	**153.2**
Conformité:	**Conforme**

ELECTRODES ADULTES:

Photo:



Rapport d’intervention

Conformité:	**Conforme**
Electrodes ou adaptateur pédiatrique NON inclues	☑

BATTERIE / PILE

Photo:



Conformité:	**Conforme**

CONFORMITE DU DEFIBRILLATEUR

Test de conformité:	**Conforme**

ARMOIRE/SUPPORT :

Armoire/Support:	**Oui**
Marque:	**AUTRE**

Photo:



Rapport d'intervention

Alarme:	**Non**
Chauffage	**Non**
Ventilation:	**Non**
Armoire/Support conforme	**Oui**

ACCESSOIRES :

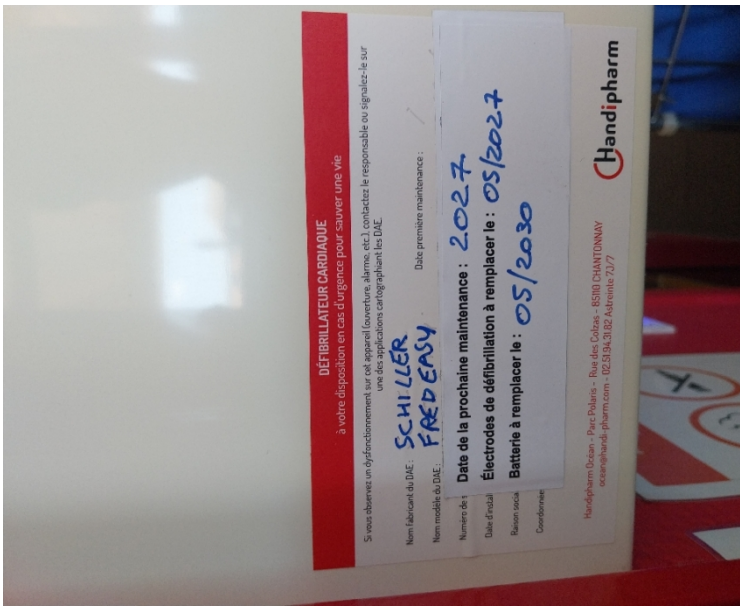
Trousse de secours:

Conformité	**Conforme**

Signalisation / Fléchage:

Conformité	**Conforme**

Affichage Règlementaire:

Conformité	**Conforme**
Photo de l'affichage règlementaire	

Intervention terminée ?	**Oui**
Photos supplémentaires?	☑
Présence d'un contact sur site ?	**Oui**
Nom du contact sur site	**Mme Gervais**
Signature	

17/06/2026 15:20